


Согласовано

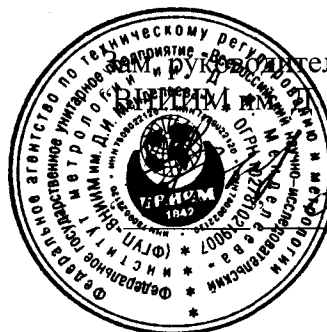

Директора ГЦИ СИ  
И. Менделеева”

Александров В.С.  
2007 г.

Газоанализаторы Drager X-am 7000	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 29109-07 Взамен № 29109-05
-------------------------------------	--

Выпускаются по технической документации фирмы «Drager Safety AG & Co.KGaA», Германия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы Drager X-am 7000 предназначены для автоматического непрерывного измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода и массовой концентрации вредных газов на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и при аварийных ситуациях, а также дозврывоопасных концентраций горючих газов во взрывоопасных зонах.

Область применения - контроль воздуха рабочей зоны.

### ОПИСАНИЕ

Газоанализатор Drager X-am 7000 представляет собой газоанализатор со сменными сенсорами, обеспечивающими контроль содержания в воздухе кислорода, диоксида углерода, вредных и горючих газов, приведенных в таблицах 1, 2, 3.

Прибор состоит корпуса, в котором установлены пять сменных сенсоров, микропроцессор, блок питания.

В состав газоанализатора Drager X-am 7000 могут входить:

один термokatалитический, один оптический и до трех электрохимических сенсоров или

два оптических и до трех электрохимических сенсоров или

два термokatалитических и до трех электрохимических сенсоров,

Сенсоры имеют следующее назначение:

- термokatалитические - для измерения дозврывоопасных концентраций горючих газов,

- оптические (IR) - для измерения дозврывоопасных концентраций горючих газов и диоксида углерода,

- электрохимические - для определения содержания кислорода и вредных газов.

Принцип действия каталитического сенсора заключается в следующем: анализируемый воздух диффундирует через проницаемую металлическую мембрану в сенсор. Там горючий газ или пар каталитически сгорает на поверхности детектора. Необходимый для сгорания кислород берется из окружающего воздуха. При сгорании детектор дополнительно нагревается. Нагрев приводит к изменению сопротивления детектора. Это изменение сопротивления пропорционально парциальному давлению горючего газа или пара. В сенсоре находится кроме каталитически активного детектора и неактивный компенсационный элемент. Оба эти элемента являются частями моста. Влияние таких факторов, как температура окружающей среды, влажность воздуха воздействуют на оба элемента в равной степени, поэтому эти влияния на измерительный сигнал полностью компенсируются. Исходя из напряжения моста сенсора определяется концентрация газа в % НКПР или в объемной доли в %.

Принцип действия электрохимических сенсоров заключается в том, что анализируемый окружающий воздух диффундирует через капилляры к измерительному электроду. Там происходит электрохимическая реакция. Между измерительным электродом и дополнительным электродом сравнения за счет этой реакции возникает соответствующая постоянная разность потенциалов, пропорциональная содержанию определяемого компонента.

Принцип действия сенсоров IR – оптический (инфракрасный).

Встроенный микропроцессор управляет всем процессом измерений и преобразует сигналы сенсоров в показания на дисплее. Дисплей прибора на жидких кристаллах одновременно индицирует 5 формул определяемых компонентов и их содержание в анализируемой газовой пробе.

На лицевой панели газоанализатора расположен 5-ти строчный цифровой дисплей, кнопки со стрелками для выключения прибора, выбора нужного меню и контроля пароля, кнопка со стрелкой для включения и выключения газоанализатора.

Газоанализаторы имеют установку двух регулируемых порогов срабатывания сигнализации с выдачей световой и звуковой сигнализации.

Способ подачи анализируемого газа – диффузионный или принудительный (прокачивание пробы с использованием насоса).

Газоанализатор может поставляться с блоком памяти для вывода данных на компьютер с использованием разработанной фирмой специальной программой «GasVision».

Маркировка взрывозащиты: PB Exdial X/1 Exdial IСТ4 X.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов Drager X-am 7000 приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1.

Метрологические характеристики газоанализатора Drager X-am 7000  
по каналам с термокаталитическими сенсорами

Тип датчика	Определяемый компонент	Диапазон измерений показаний		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР
		% НКПР	% (об)	
CAT Ex 68 10 410;  CAT Ex 68 10 710	метан (CH <sub>4</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 2,2	± 5
		50 ÷ 100	2,2 ÷ 4,4	не нормирована
	пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 0,85	± 5
		50 ÷ 100	0,85 ÷ 1,7	не нормирована
	бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	0 ÷ 60	0 ÷ 0,85	± 5
		60 ÷ 100	0,85 ÷ 1,4	не нормирована
	изобутан (и-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	0 ÷ 50	0 – 0,65	± 5
		50 ÷ 100	0,65 ÷ 1,3	не нормирована
	пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 0,7	± 5
		50 ÷ 100	0,7 ÷ 1,4	не нормирована
	гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 0,5	± 5
		50 ÷ 100	0,5 ÷ 1,0	не нормирована
	этилен (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 1,15	± 5
		50 ÷ 100	1,15 ÷ 2,3	не нормирована
	водород (H <sub>2</sub> )	0 ÷ 50	0 ÷ 2,0	± 5
		50 ÷ 100	2,0 ÷ 4,0	не нормирована
	аммиак (NH <sub>3</sub> )	0 ÷ 33,3	0 ÷ 5,0	± 5
		33,3 ÷ 100	5,0 ÷ 15,0	не нормирована

Примечания:

1. НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени. значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ Р 52136-2003.

2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности нормированы при условии наличия в контролируемой среде только одного определяемого компонента.

Время установления показаний для термокаталитических сенсоров, не более: 30 с.

Время срабатывания сигнализации, с, не более:

15

Таблица 2.

Метрологические характеристики газоанализатора Drager X-am 7000  
по каналам с электрохимическими сенсорами и оптическими сенсорами IR CO<sub>2</sub>, IR Ex

Обозначение сменного сенсора	Измерительный канал (определяемый компонент)	Диапазон показаний объёмной доли, ppm (%)	Диапазон измерений объёмной доли, ppm (%)	Пределы допускаемой основной погрешности, %		Номинальная цена единицы наименьшего разряда дисплея ppm	Время установления показаний, T <sub>0,9</sub> , с	Назначение
				Приведенной (γ)	Относительной (δ)			
XS EC H <sub>2</sub> S 68 09 110,  XS R H <sub>2</sub> S 68 10 260, XS 2 H <sub>2</sub> S 100 68 10 370 XS 2 H <sub>2</sub> S SR 68 10 575	Сероводород	0 - 20 0 - 100	0 - 7 7 - 100	± 20 -	- ± 20	1	20	Контроль ПДК* и при аварийных ситуациях
XS EC H <sub>2</sub> S HC 68 09 180	Сероводород	0 - 100 0 - 500	0 - 50 50 - 500	± 15 -	- ± 15	1	25	При аварийных ситуациях
XS EC CO 68 09 105,  XS R CO 68 10 258, XS 2 CO 68 10 365	Оксид углерода	0 - 100 0 - 500 0 - 2000	0 - 20 20 - 2000	± 15 -	- ± 15	1	35  30  20	Контроль ПДК и при аварийных ситуациях
XS EC CO HC 68 09 120	Оксид углерода	0-10000	0 - 3000 3000 - 10000	± 10 -	- ± 10	5	30	При аварийных ситуациях
XS EC Cl <sub>2</sub> ) 68 09 165	Хлор	0 - 1 0 - 10 0 - 20	0 - 1 1 - 20	± 20 -	- ± 20	0,05	30	- « -
XS EC CO <sub>2</sub> 68 09 175	Диоксид углерода	(0 - 2,5) % (0 - 5) %	(0 - 1) % (1 - 5) %	± 15 -	- ± 15	0,1 %	45	-
XS EC H <sub>2</sub> 68 09 185	Водород	0 - 500 0 - 1000 0 - 2000	0 - 500 500 - 2000	± 15 -	- ± 15	5	20	-

XS EC HCN 68 09 150	Цианис- тый водо- род	0 – 30 0 - 50	0 - 10 10 - 50	± 15 -	- -	0,1	10	При ава- рийных ситуациях
XS EC Hy- dride **) 68 09 135	Фосфин, арсин	0 - 1 0 – 20	0 - 0,2 0,2 - 1 -	± 20 - -	- ± 20 -	0,01	10	- « -
XS EC NH <sub>3</sub> 68 09 145	Аммиак	0 - 50 0 - 200	0 - 20 20 - 200	± 15 -	- ± 15	1	20	Контроль ПДК и при аварийных ситуациях
XS EC NO 68 09 125	Оксид азота	0 - 20 0 – 50 0 – 200	0 - 20 20 - 200	± 15 -	- ± 15	0,5	30	При ава- рийных ситуациях
XS EC NO <sub>2</sub> 68 09 155	Диоксид азота	0 – 10 0 – 20 0 – 50	0 – 10 10 - 50	± 15 -	- ± 15	0,1	15	- « -
XS EC Amine ***) 68 09 545	Димети- ламин, тримети- ламин, диэтила- мин, триэти- ламин	0 - 50 0 – 100	0 – 20 20 - 100	± 20 -	- ± 20	1	30	- « -
XS EC Odorant ***) 68 09 200	Метил- маркап- тан, этилмер- каптан	0 - 20 0 – 40	0 - 10 10 - 40	± 20 -	- ± 20	0,5	90	- « -
XS EC COCl <sub>2</sub> 68 08 582	Фосген	0 – 1 0 – 3	0 – 0,2 0,2 - 3	± 20 -	- ± 20	0,01	60	- « -
XS EC OV- A (Organic Vapors ****) 68 09 522	Стирол C <sub>8</sub> H <sub>8</sub>	0 – 100	-	-	-	0,5	90	-
XS EC OV (Orga-nic Vapors ****) 68 09 115	Этанол C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH,  Этилен C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ,  Метанол CH <sub>3</sub> OH,	0 - 100 0 - 200 0 - 300  0 - 20 0 - 50 0 - 100  0 - 20 0 - 50 0 - 200	0 – 50 50 - 300  0 - 20 20 - 100  -	± 20 -  ± 20 -  -	- ± 20  - ± 20  -	0,5	240	Контроль 0,3 ПДК  Контроль ПДК  -

XS EC SO <sub>2</sub> 68 09 160	Диоксид серы	0 – 10 0 - 20 0 – 100	0 - 4 4 - 100	± 15 -	- ± 15	0,1	20	Контроль ПДК и при аварийных ситуациях
XS EC O <sub>2</sub> LS 68 09 130	Кислород	0 – 25 %	0 - 5 % 5 - 25 %	± 5 -	- ± 5	0,1 %	25	-
XS R O <sub>2</sub> LS 68 10 262							20	
XS 2 O <sub>2</sub> 68 10 375								
XS EC O <sub>2</sub> 100 68 09 550	Кисло- род	(0 – 100) %	(0 – 100) %	± 1 -	-	0,5 %	5	-
Smart IR CO <sub>2</sub> 68 10 590	Диоксид углерода	(0 – 5) % .	(0 – 1) % (1 – 5) % .	± 10 -	- ± 10	0,01 %	45	-
Smart IR CO <sub>2</sub> 68 10 599	Диоксид углерода	(0 – 100) % .	(0 – 5) % (5 -100) % .	± 5 -	- ± 5	0,01 %	45	-
Smart IR Ex 68 10 460	Метан	(0 – 100) % .	(0 – 100) % .	± 5 -	- -		40	-

Примечания:

1. \*) определение содержания хлора при отсутствии фтора, брома и ClO<sub>2</sub>.

\*\* определение содержания фосфина при отсутствии арсина и наоборот, при определении указанных компонентов должны отсутствовать B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, GeH<sub>4</sub>, SiH<sub>4</sub>;

\*\*\* электрохимический датчик XS EC Amine 68 09 545, XS EC Odorant 68 09 200 использовать при условии наличия в контролируемой среде только одного определяемого компонента.

Если в анализируемом воздухе присутствуют 2 и более определяемых компонентов, а также мешающие компоненты (меркаптаны и другие компоненты, приведенные в РЭ на датчик), то указанный канал используется в качестве индикатора для предварительной оценки содержания определяемых компонентов с последующим анализом по методикам выполнения измерений (МВИ), разработанным и аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

\*\*\*\* Электрохимические датчики XS EC OV и OV A (Organic Vapors) XS EC на метанол и стирол, соответственно, используются для предварительной оценки с последующим анализом по методикам выполнения измерений (МВИ), разработанным и аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

2. ПДК – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

Таблица 3.

Метрологические характеристики газоанализатора Drager X-am 7000

с оптическими сенсорами IR Ex

Обозначение сенсора	Измерительный канал (пределаемый компонент)	Диапазон измерений (показаний)		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, (Δ), % НКПР (для определяемого компонента)	Поверочный компонент	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, (Δ), % НКПР (для поверочного компонента)
		НКПР, %	объемной доли, %			
Smart IR Ex, 68 10 460	Метан $\text{CH}_4$	0 – 50	0 – 2,2	$\pm 5$	Метан	$\pm 5$
		50 – 100	2,2 – 4,4	$\pm 10$ % отн.	-	-
	Пропан $\text{C}_3\text{H}_8$	0 – 50	0 – 0,85	$\pm 5$	Пропан	$\pm 5$
		50 – 100	0,85 – 1,7	$\pm 10$ % отн.	-	-
	Бутан $\text{C}_4\text{H}_{10}$	0 – 50	0 – 0,7	$\pm 5$	Пропан Бутан	$\pm 5$
		50 – 100	0,7 – 1,4	Не нормирована	-	-
	Изобутан $\text{C}_4\text{H}_{10}$	0 – 50	0 – 0,7	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 – 100	0,7 – 1,4	$\pm 10$ % отн.	-	-
	Ацетон $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$	0 – 50	0 – 1,25	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 – 100	1,25 – 2,5	Не нормирована	-	-
	1,3-Бутадиен $\text{CH}_2\text{CHCHCH}_2$	0 – 50	0 – 0,7	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 – 100	0,7 – 1,4	Не нормирована	-	-
	Циклопентан $\text{C}_5\text{H}_{10}$	0 – 50	0 – 0,7	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 – 100	0,7 – 1,4	Не нормирована	-	-
	Диэтиловый эфир $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{O}$	0 – 50	0 – 0,85	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$

Smart IR Ex, 68 10 460	$(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{O}$	50 - 100	0,85 – 1,7	Не нормирована	-	-
	Этан $\text{C}_2\text{H}_6$	0 – 50	0 – 1,25	$\pm 5$	Пропан Этан	$\pm 5$
		50 - 100	1,25 – 2,5	$\pm 10\%$ отн.	-	-
	Этилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	0 – 50	0 – 1,1	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	1,1 – 2,2	Не нормирована	-	-
	н-Бутилен (н-Бутен) $\text{C}_4\text{H}_8$	0 – 50	0 – 0,8	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	0,8 – 1,6	Не нормирована	-	-
	Метанол $\text{CH}_3\text{OH}$	0 – 50	0 – 2,75	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	2,75 – 5,5	Не нормирована	-	-
	Хлорметан $\text{CH}_3\text{Cl}$ (фреон R 40)	0 - 50	0 – 3,8	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	3,8 – 7,6	Не нормирована	-	-
	Дихлорметан (метиленхлорид) $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ (фреон R 30)	0 - 50	0 – 6,5	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	6,5 – 13	Не нормирована	-	-
	Метилэтилкетон (бутанон) $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$	0 - 50	0 – 0,9	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	0,9 – 1,8	Не нормирована	-	-
	Гексан $\text{C}_6\text{H}_{14}$	0 – 50	0 – 0,5	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	0,5 – 1,0	Не нормирована	-	-
	о-Ксилол $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	0 – 50	0 – 0,5	$\pm 8$	Пропан	$\pm 5$
		50 - 100	0,5 – 1,0	Не нормирована	-	-

Примечания:

1. НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени, значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ Р 52136-2003.

2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности нормированы при условии наличия в контролируемой среде только одного определяемого компонента.

3. Предел допускаемой вариации показаний в долях от пределов допускаемой основной погрешности составляет 0,5.

4. Предел допускаемого изменения выходного сигнала (показаний) при непрерывной работе ( $\Delta t_d$ ), в долях от предела допускаемой основной погрешности:

для электрохимических сенсоров	за 1 месяц	0,8;
для термодаталитических сенсоров	за 1 месяц	0,2;
для оптических датчиков -		
по поверочному компоненту	за 1 месяц	0,3;
по определяемым компонентам	за 1 месяц	0,6;

5. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения температуры и влажности окружающей среды, атмосферного давления приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование дополнительной погрешности	Модель сенсора		
	электро- хи- мический	термока- талитиче- ский	оптиче- ский
1. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающей среды в пределах рабочих условий на каждые 10 °С, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5	0,3	0,3
2. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения относительной влажности окружающей среды от 60 до 0 % и от 60 до 100 % в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,5	0,5	0,4
3. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения атмосферного давления в пределах рабочих условий на каждые 3,3 кПа, в долях от предела допускаемой основной погрешности	0,2	0,2	0,3

6. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения скорости потока анализируемой пробы в пределах от 0 до 6 м/с в долях от пределов допускаемой основной погрешности не превышает 0,6.

7. Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния неизмеряемых компонентов (для электрохимических сенсоров), перечень которых указан в Руководстве по эксплуатации на газоанализатор X-am 7000, и содержание которых не более санитарных норм по ГОСТ 12.1.005, в долях от предела допускаемой основной погрешности: 1,5.

8. Время работы газоанализаторов без подзарядки аккумуляторного блока питания: при эксплуатации с NiMH (3 А) блоком питания от 9 до 27 ч, с NiMH (6 А) блоком питания от 18 до 54 ч, при эксплуатации с блоком питания на щелочных батареях от 12 до 16 ч (в зависимости от количества сенсоров).

9. Габаритные размеры (с блоком питания), мм, не более: длина - 155, ширина - 142, высота - 74.

10. Масса газоанализатора, не более: 600 г.

С блоком питания, не более: 1330 г.

11. Срок службы газоанализаторов (исключая сенсоры) не менее 8 лет  
 Срок службы сенсоров от 9 до 36 месяце (60 месяцев – для оптических сенсоров).  
 Срок службы насоса, не менее: 1000 часов  
 Количество циклов при работе с одним аккумулятором, не менее: 400.
12. Условия эксплуатации:  
 температура окружающей среды от минус 30 до 55 °С (60 °С - временно);  
 атмосферное давление от 700 до 1300 гПа.;  
 относительная влажность от 10 до 95 %.
- содержание неизмеряемых компонентов не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1.005.
13. Количество регулируемых порогов срабатывания сигнализации: 2

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят типографским способом на специальную наклейку на задней панели газоанализаторов и на титульный лист руководства по эксплуатации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки газоанализаторов Drager X-am 7000 приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение	Количество
Газоанализатор Drager X-am 7000*		1 шт.
Сенсоры*	**	1-5 шт.
Блок питания:*		
NiMH (3 А)	83 17 408	1 шт.
NiMH (6 А)	83 17 454	
Блок питания на щелочных батареях	83 17 550	
Зарядная станция на один или несколько (до 8) приборов		1 шт.
Принадлежности:		
Заглушка (4 шт.)	83 17 337	1 шт.
Комплект фильтров для сенсоров	83 17 805	1 шт.
Кожаная сумка для переноски	83 17 683	1 шт.
Защитный чехол	83 17 397	1 шт.
Несущее основание, включая ремень	83 16 678	1 шт.
Поясной ремень	83 17 682	1 шт.
Зажим для крепления	83 17 771	1 шт.
Для работы в режиме прокачки:		
Адаптер насоса	83 17 397	1 шт.
Зонд для обнаружения утечек 70	83 16 531	1 шт.
Зонд 90	8316532	1 шт.
Телескопический зонд	83 16 530	1 шт.
Шланг для поплавкового зонда длиной 10 м	11 80 681	1 шт.
Витоновый шланг (в т.ч.и для H <sub>2</sub> S)	12 03 150	1 шт.
Для обработки результатов измерений:		
Программа для PC GasVision (MS Windows)	83 14 034	1 шт.
Инфракрасный интерфейс для PC	64 08 515	1 шт.

Программа для РС «СС-Vision»	64 08 515	1 шт.
Калибровочный адаптер X-am 7000	83 18 656	1 шт.
Руководство по эксплуатации с дополнением		1 экз.
Методика поверки (приложение № 1 к Руководству по эксплуатации)		1 экз.

Примечание: \*) Обязательная поставка. Остальные позиции поставляются по отдельному заказу.

\*\*) Поставляется в соответствии с заказом по перечню сенсоров, приведенных в таблицах №№ 1, 2, 3.

## ПОВЕРКА

Поверку газоанализаторов Drager X-am 7000 осуществляют в соответствии с документом МП-242-0576-2007 «Газоанализаторы Drager X-am 7000. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" «24» августа 2007 г.

Основные средства поверки:

- генератор газовых смесей ГГС-03-03 по ШДЕК.418313.001 ТУ (№ 19351-05 в Госреестре РФ) в комплекте с ГСО-ПГС состава  $H_2S/N_2$ ,  $CO/N_2$ ,  $H_2/N_2$ ,  $NH_3/N_2$ ,  $NO/N_2$ ,  $NO_2/N_2$ ,  $SO_2/N_2$  в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92;

- генератор термодиффузионный ТДГ-01 по ШДЕК.418319.001 ТУ (№ 19454-05 в Госреестре РФ) в комплекте с источниками микропотоков ИМ на хлор, метилмеркаптан, этилмеркаптан по ИБЯЛ.418319.013 ТУ;

- газоаналитический комплекс «МОГАИ-6» ИРМБ.413426.001 РЭ (№ 19858-00 в Госреестре РФ) для получения ПГС на основе HCN;

- установка газодинамическая высшей точности УВТ-Ф для получения ПГС на основе  $PH_3$  (регистрационный № 60-А-89);

- динамическая установка ГДУ-3Л гЯ.6433.00.00.000 ТО для получения ПГС на основе диметиламина, триметиламина, диэтиламина, триэтиламина;

- установка высшей точности УВТ-Ф для получения ПГС на основе  $AsH_3$  (регистрационный № 59-А-89);

- газодинамическая установка ГДУ-34 гЯ.6434.00.00.000 РЭ (№ 20616-00 в Госреестре РФ) для получения ПГС на основе  $COCl_2$ ;

- ГСО-ПГС  $CH_4$ /воздух,  $C_3H_8$ /воздух,  $C_4H_{10}$ /воздух,  $C_6H_{14}$ /воздух,  $C_2H_4$ /воздух,  $H_2$ /воздух,  $O_2/N_2$ ,  $CO_2/N_2$ , по ТУ 6-16-2956-92;

- ПГС  $C_5H_{12}$ /воздух – эталонный материал ВНИИМ ЭМ №№ 06.02.630, 06.02.631;

- поверочный нулевой газ - воздух по ТУ 6-21-5-82;

- азот особой чистоты в баллоне под давлением по ГОСТ 9392-74.

Допускается применять другие средства поверки, не приведенные в перечне, но обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 8.578-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах»;

2. ГОСТ 13320 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».

3. ГОСТ 27540 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия».

4. ГОСТ 12.2.007.0 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Требования безопасности».

5. ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования».

6. ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-99) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть I. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

7. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть II. Искробезопасная электрическая цепь».

8. ГОСТ Р 52138-2003 «Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана в воздухе до 100 %».

9. ГОСТ Р 52140-2003 «Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 %».

10. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

9. Техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип газоанализаторов Drager X-am 7000 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при ввозе в страну, после ремонта и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Газоанализаторы Drager X-am 7000 имеют решение о подтверждении действия сертификата соответствия РОСС DE.ГБ05.В01743, выданное НАНАО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» 14.06.2007 г.


Газоанализаторы модели X-am 7000 имеют Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России № РРС 00-22977 на применение во взрывоопасных зонах, выданное 01.12.2006 г.

Изготовитель фирма «Drager Safety AG & Co.KGaA»  
Revalstrasse 1, 23560, Luebeck, Germany, Tel +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 2080

Руководитель научно-исследовательского  
отдела Государственных эталонов  
в области физико-химических измерений  
ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Глава представительства фирмы  
«Drager Safety AG & Co.KGaA»

 Л.А. Конопелько

 Михаэль Мюлиш

**Drägersafety**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany  
www.dräger.com

20.08.07