



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.001.A № 42309

Срок действия до 17 марта 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Машины для испытания на сжатие ИП-1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Точмашприбор", г.Армавир
Краснодарского края

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46534-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.136-74

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **17 марта 2011 г. № 1156**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

В.Н.Крутиков

"....." 2011 г.

Серия СИ

№ 000248

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Машины для испытания на сжатие ИП-1

Назначение средства измерений

Машины для испытания на сжатие ИП-1 (далее – машины) предназначены для измерений значений силы, при которой происходит разрушение стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180-90 и других строительных материалов при их статических испытаниях.

Описание средства измерений

Принцип действия машин заключается в измерении нагрузки на образце, задаваемой с помощью гидравлического привода, при деформации образцов до разрушения при контролируемой скорости нагружения. Измерение нагрузки производится путем преобразования давления в рабочем цилиндре в пропорциональный электрический сигнал с последующей обработкой этого сигнала в блоке измерения измерительной системы.

Машины представляют собой установку, состоящую из нагружающего устройства и пульта.

Нагружающее устройство состоит из основания, траверсы, двух резьбовых колонн, шаровой опоры с верхней плитой, рабочего цилиндра с нижней опорной плитой.

Пульт состоит из насосной установки и измерительной системы. Насосная установка состоит из бака, насосов нагнетания рабочей жидкости и гидравлического привода.

Измерительная система состоит из преобразователя измерительного и блока измерения.

Машины имеют четыре модификации, отличающиеся диапазонами измерения нагрузки, габаритными размерами и массой.

Машина ИП-100-1 по заказу потребителя оснащена приспособлением для испытаний образцов на изгиб по ГОСТ 10180-90.



Рис. 1. Общий вид

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики машин приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Модификация машин			
	ИП-100-1	ИП-500-1	ИП-1000-1	ИП-2000-1
1	2	3	4	5
Наибольшая предельная нагрузка, кН	100	500	1000	2000
Наименьшая предельная нагрузка, кН	1	5	10	20
Диапазоны измерения нагрузки, кН				
– основной	от 2 до 100	от 10 до 500	от 20 до 1000	от 40 до 2000
– дополнительный	от 1 до 2	от 5 до 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Высота рабочего пространства, не менее, мм	350	360	500	610
Ширина рабочего пространства, не менее, мм	230	340	390	530
Размеры опорных плит (длина, ширина), не менее, мм	210; 210	320; 320	320; 320	320; 320
Ход поршня рабочего цилиндра, не менее, мм	100	100	100	100
Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра вверх без нагрузки, не менее, мм/мин.	600	160	120	60
Диапазон скоростей нагружения, кН/с	от 0,25 до 25,0	от 0,5 до 25,0	от 1,0 до 100,0	от 2,0 до 100,0
Пределы допускаемой погрешности машины при измерении нагрузки при прямом ходе:				
– относительной в основном диапазоне измерения в % от измеряемой нагрузки	± 1			
– приведенной в дополнительном диапазоне измерения, % от предельной нагрузки диапазона	± 1			
Размах показаний машины (разность между наибольшими и наименьшими показаниями трех измерений нагрузки при прямом ходе), не более:				
– в основном диапазоне измерения в % от измеряемой нагрузки	1			
– в дополнительном диапазоне измерения, % от предельной нагрузки диапазона	1			
Вариация показаний машины (разность показаний между прямым и обратным ходами), не более:				
– в основном диапазоне измерения в % от измеряемой нагрузки	3			
– в дополнительном диапазоне измерения, % от предельной нагрузки диапазона	3			

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения, начиная со значения равного 0,2 наибольшей предельной нагрузки машины до разрушающей нагрузки испытуемого образца, % от заданной скорости нагружения	± 25			
Потребляемая мощность, не более, кВт	1,1	1,5	2,6	2,6
Электрическое питание от сети переменного тока: – напряжение, В – частота, Гц	от 360 до 440 от 49 до 51			
Условия эксплуатации: – температура $^{\circ}\text{C}$ – относительная влажность, %	от +10 до +35 до 80			
Степень защиты пульта по ГОСТ 14254-96	IP20			
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более, мм:	1010, 605, 1330	1120, 600, 1350	1480, 750, 1850	1740, 900, 2300
Масса, не более, кг	340	680	1540	3160
Вероятность безотказной работы за 2000 ч	0,92			
Средний срок службы, лет	15			

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наноситься на табличках, установленных на нагружающем устройстве и пульте, методом фотохимпечатания и на руководстве по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

1. Нагружающее устройство – 1 шт.
2. Пульт – 1 шт.
3. Комплект инструмента и принадлежностей – 1 компл.
4. Комплект сменных частей – 1 компл.
5. Руководство по эксплуатации – 1 экз.
6. Формуляр – 1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.136-74 ГСИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки.

Сведения о методиках (методах) измерений изложены в руководстве по эксплуатации «Машины для испытания на сжатие ИП-1. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к машинам для испытания на сжатие ИП-1

1. ГОСТ 28840-90 Машины для испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования.
2. ГОСТ 8.065-85 ГСИ. Государственный первичный эталон и Государственная поверочная схема для средств измерений силы.

3. ГОСТ 8.136-74 ГСИ. Прессы гидравлические для испытаний строительных материалов. Методы и средства поверки.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

применяются при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Точмашприбор»,

Адрес: 352913, г. Армавир Краснодарского края, Северная промзона, ОАО «Точмашприбор».

Испытательный центр


ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», регистрационный номер 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru, <http://www.vniim.ru>

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

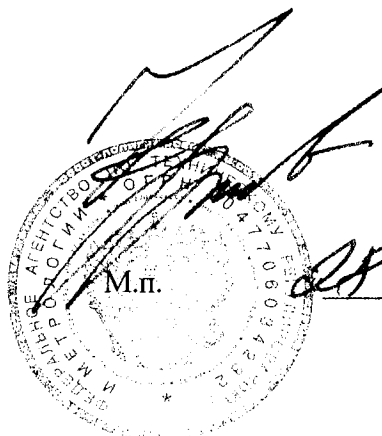

В.Н. Крутиков

« 03 » 2011 г.