



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 48525

Срок действия до 22 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты
"Тверца-900"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Электронные технологии"
(ООО "ЭЛТЕХ"), г. Тверь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51559-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 51559-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2012 г. № 876

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007098

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900»

Назначение средства измерений

Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900» (далее по тексту – устройства) предназначены для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока и измерения воспроизводимого напряжения и силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия устройств основан на формировании цифровых сигналов с помощью блока управления, их последующем цифро-аналоговом преобразовании, усилении и воспроизведении с помощью аппаратного блока.

Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца» выпускаются двух модификаций: «Тверца-900» и «Тверца-900М». Отличие моделей заключается в наличии GSM-модема у модели «Тверца-900».

Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты «ТВЕРЦА-900» предназначено используется для электрохимической защиты трубопроводов и металлических конструкций от коррозии.

Устройство работает либо в режиме стабилизации тока либо в режиме стабилизации напряжения.

Устройство выполнено в виде преобразователя, размещаемого внутри металлического шкафа со вспомогательным оборудованием.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения измерителей приведены в таблице 1.

Системное программное обеспечение (встроенное) реализовано аппаратно и является метрологически значимым.

Внешнее ПО «GSM Monitor» устанавливается на персональный компьютер и предназначено для сбора информации с устройств, хранения и представления пользователю в удобном виде.

Встроенное программное обеспечение устройств может быть проверено, установлено или переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических устройств.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер программного обеспечения)	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
GSM Monitor (Внешнее)	SKZMainModule.exe	2.9.0.0	AC3D980CEF23CA3D598F47B9F55FDFD3	md5
Встроенное	V14.hex	14.0	9A4DAC925990A370FECF225CC36304FC	md5

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «С» в соответствии с МИ 3286-2010.

Внешний вид и схема пломбирования устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900» представлены на рисунке 1.

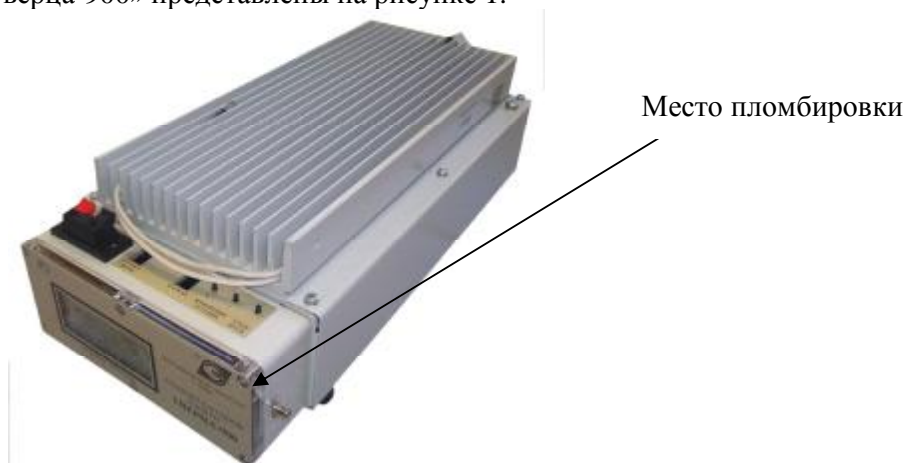


Рисунок 1 – Внешний вид и схема пломбирования

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны воспроизведения и измерения величин, а также пределы допускаемых основных погрешностей измерений приведены в таблице 2.

Метрологические характеристики нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

Таблица 2

Характеристика	Значение
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока основного выхода, В	0 – 60
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока основного выхода, В	$\pm 0,5$
Пределы дополнительной температурной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, на каждые 10 °С, не превышает, В	$\pm 0,1$
Пульсации выходного напряжения постоянного тока для основного выхода не более, мВ	± 500
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока, А	0 – 15
Дискретность задания выходной силы постоянного тока, А	0,2 в диапазоне (0...3) А 0,5 в диапазоне (3...15) А
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, А	$\pm 0,15$
Пределы дополнительной температурной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, на каждые 10 °С, не превышает, А	$\pm 0,05$
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока защитного выхода, В	0 – 2,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока для защитного выхода, В	$\pm 0,025$
Дискретность задания напряжения постоянного тока защитного выхода	200 мА (до 3 А) 500 мА (до 15 А)

Характеристика	Значение
Пределы дополнительной температурной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока для защитного выхода, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, на каждые 10 °С, не превышает, мВ	± 5
Пульсации выходного напряжения постоянного тока защитного выхода не более, мВ	1000 мВ

Нормальные условия применения:

- нормальное значение температуры окружающего воздуха плюс 20 °С. Допускаемые отклонения от нормального значения ± 10 °С;
- нормальная область значений относительной влажности воздуха от 30 до 80 %;
- нормальная область значений атмосферного давления от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.);

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45 °С;
- относительная влажность воздуха 100 % при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С;

Электропитание устройств осуществляется при питании от сети переменного тока напряжением от 175 до 253 В.

Мощность, потребляемая устройствами, не более 1200 Вт.

Устройства обеспечивают непрерывный режим работы без ограничения длительности.

Максимальная выходная мощность по выходу не более 0,9 кВт.

Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Габаритные размеры (высота \times ширина \times глубина), не более: (300 \times 555 \times 555) мм.

Масса вместе с вандализационным шкафом, не более 40 кг.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель измерителей методом термопечати и на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900»	1 шт.
Дипольная антенна	1 шт.
Шкаф с установленными элементами коммутации, противогрозовой защиты, электросчетчиком, элементами контроля доступа	1 шт.
Ключ к замкам шкафа	1 шт.
Сетевой шнур питания	1 шт.
Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900».	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900».	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900».	1 экз.
Методика поверки	1 экз.
Упаковочная тара	1 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с документом МП 51559-12 «Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900». Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2012 г.

Основные средства поверки и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и тип средства поверки	Требуемые характеристики
Катушка электрического сопротивления Р310	Номинальное сопротивление 0,001 Ом, класс точности 0,01.
Вольтметр универсальный В7-78/1	Диапазон измерения напряжения постоянного тока от 0 до 1050 В, относительная погрешность $\pm 0,05$ %; Диапазон измерения силы постоянного тока от 0 до 10 А, относительная погрешность $\pm 0,1$ %.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в руководстве по эксплуатации на устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900»:

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;
2. ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
3. ТУ 3468-007-10805710-05 «Устройства для воспроизведения параметров катодной защиты «Тверца-900». Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Электронные технологии» (ООО «ЭЛТЕХ»), г. Тверь.

Адрес: Российская Федерация, 170000, г. Тверь, пл. Гагарина, 1.

Телефон (8422) 34-68-10, Факс (8422) 34-68-10 доб.199.

E-mail: eltech_tver@mail.ru, <http://www.eltech.tver.ru>.

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: office@vniims.ru.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

«_____» _____ 2012 г.